

Protocol Desfibril·ladors

Seguint les recomanacions de les diferents societats científiques sanitàries en matèria de reanimació cardiorespiratòria, el Col·legi de Metges ha instal·lat recentment en diferents llocs de l'edifici, tres unitats de Desfibril·ladors Externs Automàtics (DEA).



El DEA és un aparell sanitari electrònic portàtil que diagnostica i tracta diferents tipus de parades cardiorespiratòries, amb resultats molt satisfactoris dins dels primers 5 minuts des de la parada.

Aquests aparells s'han disposat en llocs on hi pot haver més afluència de gent, i han estat situats a la planta -1, just al costat de les aules/sales, a la planta 0, en el vestíbul inferior, i a la planta 4, just abans d'entrar al restaurant, i, estan ubicats dins d'uns armaris protectors juntament amb una màscara de reanimació (Annex 1).



Els DEA han d'ésser usats per personal entrenat pel seu ús, o per personal sanitari. Durant el mes de Juliol es van realitzar uns cursos per a personal que treballa a l'edifici per a poder realitzar aquestes tasques. Aquestes persones estan dins de l'equip de reanimació cardiorespiratòria.

Per tal de poder gestionar eficientment el sistema, s'ha creat un petit protocol d'actuació davant d'una emergència de parada cardiorespiratòria.

Protocol d'Actuació

Els Aparells desfibril·ladors, estan ubicats i protegits de possibles mal usos a l'interior d'un armari transparent de plàstic elaborat a tal efecte. Aquests armaris estan equipats amb una línia telefònica i una alarma d'obertura.

L'accés als armaris és totalment lliure. A cada costat de la tapa davantera hi ha unes incisions per a desplaçar-la frontalment, deixant lliure el desfibril·lador pel seu ús.



Qualsevol persona (treballador o no) que estigui davant d'una situació de parada cardiorespiratòria s'haurà de desplaçar immediatament al punt més proper on estan situats els DEA i actuar segons s'indica més endavant. A ser possible sempre acudiràn dues persones, una agafarà el desfibril·lador i el portarà al lloc de l'emergència i l'altre es quedarà al lloc on hi ha l'armari, per a comunicar-se amb el punt d'informació.

Per tal de ser el més operatiu a l'hora de poder gestionar l'emergència, i a la vegada, evitar un mal ús, o fins i tot un furt del desfibril·lador, un cop s'hagi obert la tapa frontal, l'equip realitzarà una trucada telefònica automàtica al punt d'informació, a l'hora que emetrà una senyal acústica i lluminosa, indicant que l'armari ha estat obert.

La persona ubicada al punt d'informació, visualitzarà quin equip és el que ha estat obert, preguntarà què succeeix i immediatament localitzarà a una de les persones de l'equip de primers auxilis, per a que es dirigeixi cap al lloc de l'emergència.

També donarà instruccions a les persones que estiguin en el lloc de l'emergència, mitjançant el intercomunicador que disposa l'armari.

Si en el moment de l'emergència, en el lloc de l'incident, es troba alguna persona capacitada per fer servir el desfibril·lador (Metge, Sanitari, socorrista...) se l'hi ha de indicar el lloc on es troben els DEA i facilitar-los l'accés.

Una vegada l'equip d'emergència cardiorespiratòria, estigui al lloc de l'emergència, procedirà a efectuar, si s'escau, la reanimació i si fos necessari donar avís al telèfon d'emergències 112.

Una vegada acabada l'emergència, es tornarà a dipositar el Desfibril·lador dins de l'armari i restarà preparat pel següent ús.

QUADRE RESUM D'ACTUACIÓ

Emergència cardiorespiratòria



Obrir i agafar el DAE



Punt d'informació




Equip d'Emergència Cardiorespiratòria


ANNEX 1

Ubicació dels Aparells

PLANTA 4

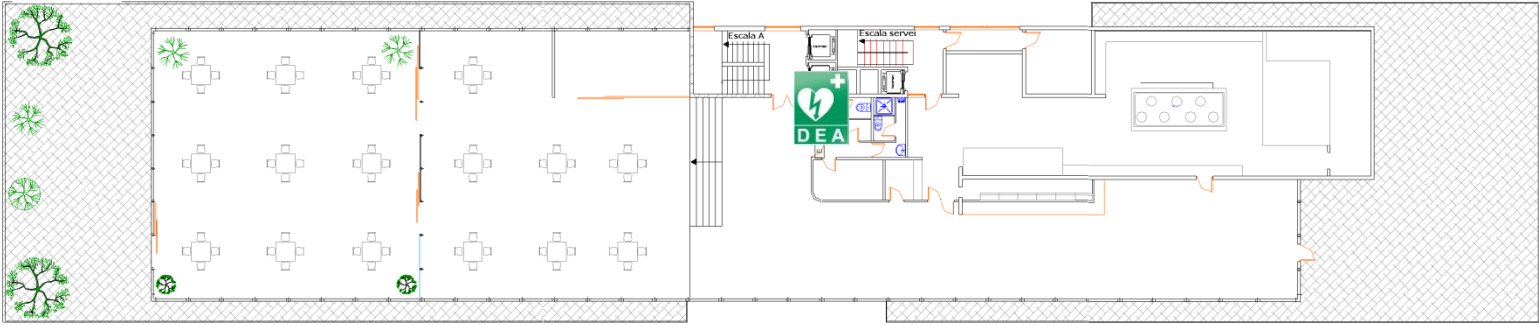

PLANTA 0

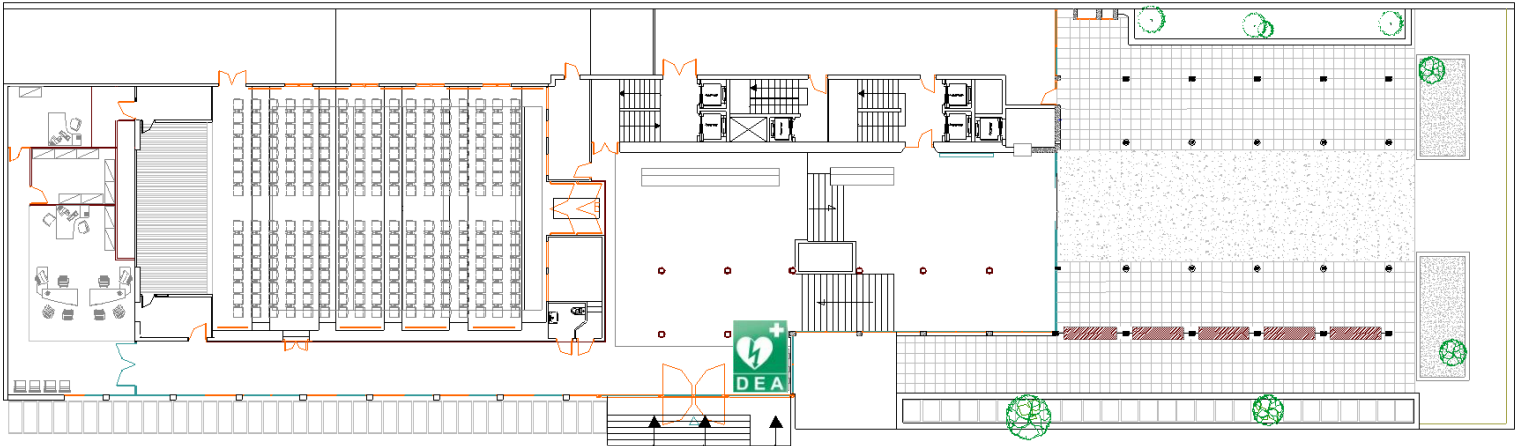

PLANTA -1

